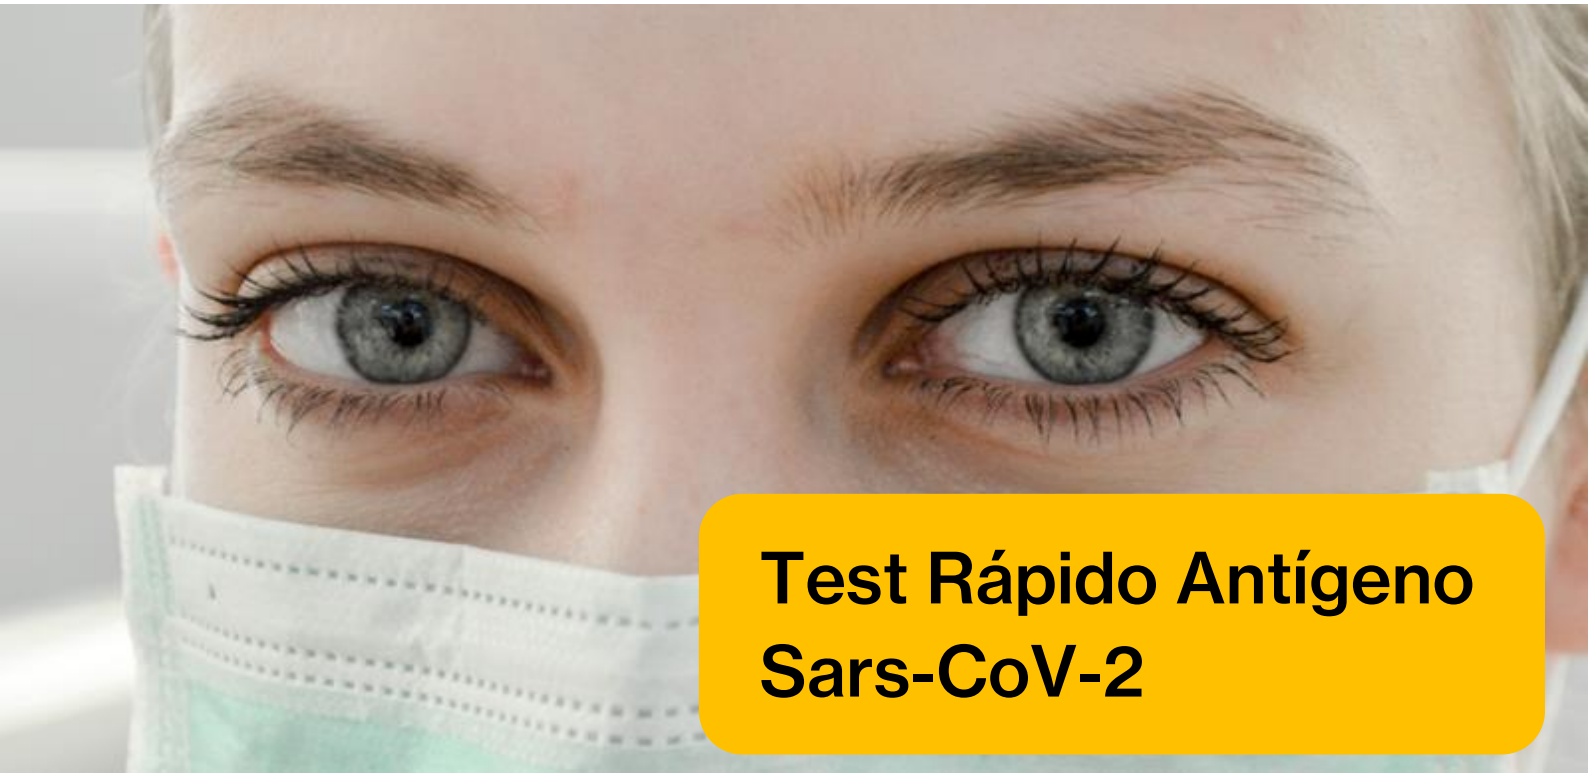

Test Rápido Antígeno Sars-CoV-2

Finalidad de la prueba

La prueba rápida ANTIGENO detecta proteínas de la membrana del virus SARS CoV-2.

Igual que la PCR, la prueba de antígeno, detecta directamente estructuras moleculares del coronavirus

SARS-CoV-2. Así, permite conocer a los pocos minutos de realizar la prueba, si una persona es portadora del virus y ser por tanto, potencialmente contagiosa.

¿Por qué es importante la detección temprana?

El Test Rápido del Antígeno SARS-CoV AMP es una prueba inmunocromatográfica rápida para la detección cualitativa del antígeno proteico de la nucleocápsida del SARS-CoV-2 en muestras de hisopos nasofaríngeos humanos como ayuda en el diagnóstico rápido y eficiente de la Enfermedad por Corona Virus 2019 (COVID-19).

¿Cuánto tardan los resultados?

La prueba está dirigida a profesionales sanitarios, es fácil de usar y sin necesidad de acudir al laboratorio.

El resultado se obtiene en sólo 15 minutos por ello es una herramienta valiosa para una detección eficiente de la infección por SARS-CoV-2.

CS NOVOTEST
INNOVATIVE TESTS

¿Cómo se realiza?

- Insertar el hisopo en la fosa nasal del paciente hasta alcanzar la superficie nasofaringea posterior (donde está presente la mayor parte de la secreción).
- Frotar girando varias veces el hisopo.

- Colocar el hisopo en el tubo junto con 10 gotas de buffer.
- Verter la solución final en la ventanilla del casete con la pipeta
- Transcurridos 15 minutos aparecerá el resultado.

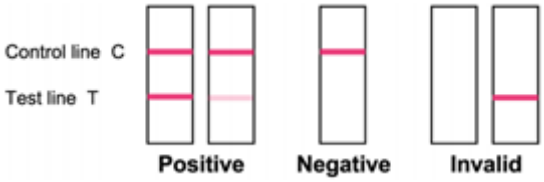

Contenido del kit

- 25 Casetes envasados individualmente en un sobre sellado.
- 25 Hisopos estériles
- 1 Buffer de extracción
- 25 Tubos de extracción y pipetas.
- 1 Soporte de tubos .

Sensibilidad y Especificidad del Test

La prueba rápida de AMP SARS-CoV-2IgG / IgM se comparó con los resultados determinados con RT-PCR.

- Sensibilidad: 86.7% (95% CI: 73.2% - 95.0%)
- Especificidad: 100.0% (95% CI: 96.9% - 100%)
- Concordancia: 95.0% (95% CI: 91.0% - 97.5%)

Pedidos:
Info@csnovotest.com
T 931.193.089 – 722.194.175